

Warszawa dn, 09.09.2008

**WYKONAWCY****DZ-2215/19/ 131 / 2008****Dotyczy : przetargu nieograniczonego nr IHiT/P/19/2008 na dostawę aparatów do leczenia nerkozastępczego metodami ciągłymi – 2 szt.****W związku z pytaniami otrzymanymi od Wykonawcy, Zamawiający uprzejmie informuje:****1. Pytanie nr 1 do punktu nr 3****„Czy Zamawiający dopuszcza aparat umożliwiający wykonywanie zabiegu HDF z POSTdylucją bez udziału PRedylucji ?”**

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapis bez zmian.

Wymóg równoczesnej substytucji przed i po filtrze w trakcie zabiegów hemofiltracji i hemodiafiltracji jest istotnym parametrem dotyczącym sposobu prowadzenia zabiegu. HDF jest najczęściej stosowanym zabiegiem nerkozastępczym.

**2. Pytanie nr 2 do punktu nr 7****„Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do przetargu aparatu przystosowanego do montażu opcjonalnego zintegrowanego modułu do prowadzenia antykoagulacji cytrynianowej, zawierającego pompę do podawania cytrynianu oraz pompę do podawania Ca<sup>++</sup>/Mg<sup>++</sup>.”**

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapis bez zmian

Istotą zapisu punktu 7 był parametr określający możliwości wykonania antykoagulacji cytrynianowej z zastosowaniem cytrynianów w niskim stężeniu, a więc bezpiecznym dla pacjenta. Ponadto Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest wyposażony w pompy infuzyjne i dlatego nie ma wymogu wyposażania aparatu w dodatkowe pompy infuzyjne.

**3. Pytanie nr 3 do punktu nr 10****„Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do przetargu aparatu posiadając komunikację z operatorem poprzez wygodne pokrętko nawigacyjne z funkcją zatwierdzania w miejsce ekranu dotykowego.”**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**4. Pytanie nr 4 do punktu nr 11****„Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do przetargu aparatu , który do wykonywania wymaganych zabiegów nie wymaga wprowadzania imienia, nazwiska i wagi pacjenta.”**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**5. Pytanie nr 5 do punktu nr 12**

**„Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do przetargu aparatu z rejestracją zdarzeń i możliwością ich archiwizacji i analizy w okresie 72h ?”**

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapis bez zmian.

Zabiegi ciągle trwają często dłużej niż 72 godziny. Wymóg dotyczy archiwizacji całego zabiegu bez względu na ilość filtrów zmienionych w czasie jego trwania.

**6. Pytanie nr 6 do punktu nr 21**

**„Czy Zamawiający dopuści do przetargu rozwiązania polegającego na zastosowaniu jednego, uniwersalnego zestawu niezależnie od prowadzonej terapii a zatem nie wymagającego identyfikacji zarówno setu jak i filtra.”**

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapis bez zmian.

Identyfikacja zestawu jest parametrem eliminującym ewentualne błędy obsługi dotyczące nastaw jak i trybów realizowanych zabiegów.

**7. Pytanie nr 7**

**„Czy Zamawiający będzie wymagał aby aparat umożliwiał zmianę zabiegu podczas prowadzenia jednej terapii u pacjenta bez konieczności wymiany zestawu?”**

Odpowiedź: Dla Zamawiającego powyższy warunek nie jest warunkiem eliminującym.

**8. Pytanie nr 8**

**„Prosimy o wyjaśnienie czy ze względu na powszechne stosowanie płynów dwuwęglanowych należy zaoferować model aparatu wyposażony w automatycznie odpowietrzanie układu?”**

Odpowiedź : Gazowanie płynów dwuwęglanowych (wydzielanie dwutlenku węgla ) występuje w trakcie ich podgrzewania. Zamawiający nie określił w SIWZ wymogu podgrzewania płynu substytucyjnego lub dializacyjnego dlatego też układ odpowietrzający nie jest wymagany

**9. Pytanie nr 9**

**„Prosimy o wyjaśnienie czy ze względów ekonomicznych należy zaoferować model aparatu przystosowany do pracy z hemofiltrami innych producentów? (bez ryzyka utraty gwarancji).”**

Odpowiedź: Zamawiający nie określa rodzaju zamawianego filtra

**10. Pytanie nr 10**

**„Prosimy o wyjaśnienie czy ze względów ekonomicznych należy zaoferować model aparatu przystosowany do pracy z płynami substytucyjnymi innych producentów? (bez ryzyka utraty gwarancji).”**


Odpowiedź: Zamawiający nie określa rodzaju stosowanych płynów.

**11. Pytanie nr 11 do punktu nr 23**

**„Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający inne rozwiązanie –DATABOX umożliwiające zbieranie i archiwizację danych dotyczącą prowadzonej terapii.”**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

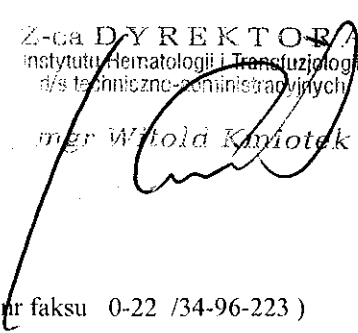

Z-ca D Y R E K T O R A  
instytutu Hematologii i Transfuzjologii  
d/s techniczne-administracyjnych  
  
mgr Witold Kmiotek

Oryginał pisma wysłano pocztą

Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma ( nr faksu 0-22 /34-96-223 )

Otrzymano dn..... podpis Wykonawcy.....