

Warszawa, dnia 03.08.....2012 r.DZ/2215/54/350...../2012**WYKONAWCY**

dotyczy: przetargu nieograniczonego, znak: IHiT/P/54/2012 na: usługę w zakresie pogwarancyjnych przeglądów i konserwacji urządzeń, aparatury oraz sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie oddziałów Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie przy ul. Indiry Gandhi 14 i ul. Chocimskiej 5 (zadania 1-35)

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Instytut Hematologii i Transfuzjologii, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) dokonuje stosownej zmiany w SIWZ.

1. Dotychczasowa treść:

Rozdział IX SIWZ, pkt 2 – Termin składania ofert do dnia 07.08.2012 r. do godz. 09:00

Zmienia się następująco:Rozdział IX SIWZ, pkt 2 – Termin składania ofert do dnia **09.08.2012 r. do godz. 09:00****2. Dotychczasowa treść:**

Rozdział X SIWZ, pkt 1 – Termin otwarcia ofert do dnia 07.08.2012 r. do godz. 10:00

Zmienia się następująco:Rozdział X SIWZ, pkt 1 – Termin otwarcia ofert do dnia **09.08.2012 r. do godz. 10:00**

Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.

Jednocześnie informujemy, że ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami na ponumerowanych stronach należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:

Nazwa i adres Wykonawcy.....

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/54/2012

Oferta na: usługę w zakresie pogwarancyjnych przeglądów i konserwacji urządzeń, aparatury oraz sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie oddziałów Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie przy ul. Indiry Gandhi 14 i ul. Chocimskiej 5 (zadania 1-35)

(ZADANIE/A NR.....)

– NIE OTWIERAĆ PRZED 09.08.2012 R GODZ. 10.00 –

DOSTARCZYĆ DO KANCELARII IHiT, POKÓJ NR 144A, I PIĘTRO

Liczba stron (określić, ile stron znajduje się w kopercie).....

Zamawiający wprowadza następujące zmiany do załącznika nr 3 – Projekt umowy:

3. Dotychczasowe brzmienie:

Projekt umowy, §1 ust.4 pkt c): „legalizację,”

Zmienia się następująco:

Projekt umowy, §1 ust.4 pkt c): „legalizację, jeżeli przepisy prawa tak stanowią”

Zamawiający wprowadza następujące zmiany do załącznika nr 1b - specyfikacja ilościowa z zakresem podstawowych do wykonania czynności:

4. Dotychczasowa treść:

Zadanie nr 14, kolumna nr 4 (Producent): Kendro Laboratory Products GmbH

Zmienia się następująco:

Zadanie nr 14, kolumna nr 4 (Producent): **Trumpf**

5. Dotychczasowa treść:

Zadanie nr 14

Zakres czynności przy przeglądzie okresowym kolumn:

1. Ocena sprawności mechanicznej
 - stan zamocowania do sufitu
 - wypoziomowanie kolumny
 - zakresy przemieszczania ramion
 - działanie hamulców
 - czytelność oznakowań, tabliczek
2. Sprawdzenie torów elektrycznych wg PN-EN 60601-1
 - pomiary rezystancji izolacji obwodów
 - sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych
 - pomiary napięć zasilających obwody
 - sprawdzenie stanu gniazd elektrycznych, zacisków PA
 - oględziny stanu oznakowań
3. Sprawdzenie torów gazowych wg PN-EN 737-3, PN-EN 737-2 (PN-EN ISO 7396-1, PN-EN ISO 7396-2)
 - braku połączeń krzyżowych
 - szczelności oraz wartości ciśnień
 - wydajności punktów poboru
 - tożsamości gazów oksymetrem lub metodą różnych ciśnień
 - prawidłowości funkcjonowania instalacji odprowadzania anestetycznych
 - sprawności mechanicznej, dedykowalności, identyfikacji punktów poboru
 - prawidłowości wskazań manometrów i urządzeń sygnalizacyjnych
 - prawidłowości funkcjonowania zaworów odcinających

Zmienia się następująco:

Zadanie nr 14

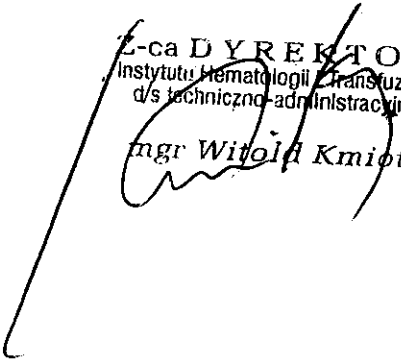
Zakres czynności przy przeglądzie okresowym kolumn:

- stan zamocowania do sufitu
- wypoziomowanie kolumny
- zakresy przemieszczania ramion
- działanie hamulców
- czytelność oznakowań, tabliczek

- pomiary rezystancji izolacji obwodów
- sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych
- pomiary napięć zasilających obwody
- sprawdzenie stanu gniazd elektrycznych, zacisków PA
- oględziny stanu oznakowań
- braku połączeń krzyżowych
- szczelności oraz wartości ciśnień
- wydajności punktów poboru
- tożsamości gazów oksymetrem lub metodą różnych ciśnień
- prawidłowości funkcjonowania instalacji odprowadzania anestetycznych
- sprawności mechanicznej, dedykwalności, identyfikacji punktów poboru
- prawidłowości wskazań manometrów i urządzeń sygnalizacyjnych
- prawidłowości funkcjonowania zaworów odcinających

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Dokonana modyfikacja specyfikacji wiąże Wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.


Z-ca D Y R E K T O R A
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
d/s techniczno-administracyjnych
mgr Witold Kmiotek