

Warszawa, dnia 15.10.2013 r.

DZ/2215/49/444/2013**WYKONAWCY**

dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawców do SIWZ w przetargu nieograniczonym znak: IHiT/P/49/2013 na „Dostawę odczynników do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej wraz z dzierżawą automatycznego analizatora immunohematologicznego”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w odpowiedzi na zapytania Wykonawców otrzymane do w/w przetargu Instytut uprzejmie wyjaśnia:

SIWZ**Pytanie nr 1**

Prosimy o doprecyzowanie czy w załączniku Nr 1 do SIWZ: Specyfikacja Asortymentowo-Cenowa w tabeli dot. „Nazwa materiału zużywalnego i zużywalnych materiałów biologicznych”, w poz. 10 nie doszło do omyłki pisarskiej i prawidłowy opis powinien brzmieć: „Krwinki do identyfikacji przeciwciał w PTA i teście enzymatycznym-panel min. 10-krwinkowy”, zgodnie z opisem badań w poz. 4 i 5 „Badanie wykonywane w PTA i teście enzymatycznym (...)”?

Odpowiedź

Zgodnie z opisem badań w poz. 4 i 5 Zamawiający wymaga zestaw krwinek do identyfikacji przeciwciał ma być wykonywany zarówno do badań w PTA, jak i teście enzymatycznym.

Pytanie nr 2

Prosimy o informację czy w związku z warunkiem, o którym mowa w pkt. 14 „Inkubator, wirówka i pipeta dedykowana do metody jako alternatywa postępowania w razie awarii analizatora i konieczności wykonania badania metodą manualną” – PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE Automatyczny analizator immunohematologiczny, Zamawiający wymaga, aby w skład oferowanego zestawu sprzętu do badań metodą manualną wchodził również dozownik do płynu do sporządzania zawiesiny krwinek?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, aby w skład oferowanego sprzętu wchodził dozownik do sporządzania zawiesiny krwinek.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści, aby część asortymentu kart była przechowywana w lodówce w temperaturze 2-8 st. C?

Odpowiedź

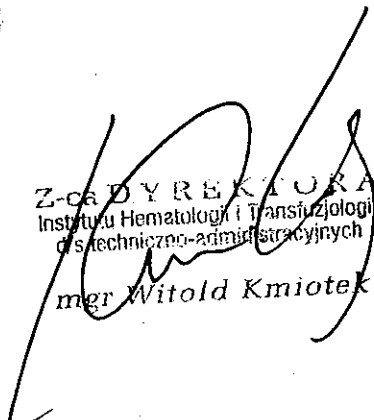
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści w Specyfikacji Asortymentowo-Cenowej w punkcie 5 w miejsce 80 badań BTA (odczynniki monowalentne anti-IgG, anti-IgM i do składników C3 dopełniacza) 80 badań BTA w konfiguracji AHG/odczynniki monowalentne anti-IgG/odczynnik do składników C3 dopełniacza/CTL? Jeżeli Zamawiającemu szczególnie zależy na ujętych w specyfikacji testach BTA, prosimy aby ze względu na dobrze pojętą konkurencję, wyłączył ww. karty do osobnego zadania.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zmiany w specyfikacji asortymentowej.


Z-ca DYREKTORA
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
dział techniczno-administracyjnych
mgr Witold Kmiotek