

Warszawa dn. 30.03.2016 r.

DZ /2215/15/152/2016

WYKONAWCY

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawców do przetargu nieograniczonego znak IHiT/P/15/2016 na dostawę materiałów eksploatacyjnych do systemu sterylizacji parowej, igieł iniekcyjnych, sprzętu do stomii, rękawiczek medycznych oraz innego drobnego sprzętu medycznego /zadania 1-17/

Zgodnie z art.38 ust.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu Instytutu Hematologii i Transfuzjologii **przekazuje treść zapytań i uprzejmie wyjaśnia:**

Pytanie 1**Dotyczy zadania 12**

Czy Zamawiający, mając na względzie zasady polskiego jak i europejskiego systemu zamówień publicznych i wiedząc, że każdorazowo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przygotowuje i przeprowadza w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców dopuści do postępowania IHiT/P/15/2016 zadanie 12 pozycja 1 termin składania ofert 01.04.2016 produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, niebieski mostek silikonowy, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej (550 ml/min) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do (1300 ml/min) przy ciśnieniu 5 PSI przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 2 szt oznaczony kolorem czerwonym tętnicy, oraz niebieskim żylny zamknięte aseptycznie papier-foolia w opakowaniu zbiorczym (karton) 36 szt z przeliczeniem zamawianej ilości czyli 72 zestawy (2 opak.)?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 3

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z zadania 12 i utworzy osobny pakiet dla tej pozycji? (...)

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji.

Pytanie 4

Czy Zamawiający w zadaniu 11 dopuszcza:

Poz. 1

Worek stomijny zamknięty z okienkiem, bez pierścienia, kolor neutralny – szary, rozmiar 50mm, 60mm oraz 70mm, możliwość stosowania dodatkowego zabezpieczenia w postaci paska (4 uszka)
-worek zamknięty, bez pierścienia, kolor przezroczysty, rozmiar 50mm, 60mm oraz 70mm, możliwość stosowania dodatkowego zabezpieczenia w postaci paska (4 uszka)

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza worek zamknięty, bez pierścienia, kolor przezroczysty, rozmiar 50mm, 60mm oraz 70mm, możliwość stosowania dodatkowego zabezpieczenia w postaci paska (4 uszka)

Pytanie 5

Czy Zamawiający w zadaniu 11 dopuszcza:

Poz. 2

worek stomijny otwarty z okienkiem, bez pierścienia zatraskowego, kolor neutralny-szary, worek zamykany na rzep, rozmiar 50mm, 60mm oraz 70mm, możliwość stosowania dodatkowego zabezpieczenia w postaci paska (4 uszka)

-worek stomijny otwarty, bez pierścienia zatraskowego, kolor przezroczysty, worek zamykany na rzep, rozmiar 50mm, 60mm oraz 70mm, możliwość stosowania dodatkowego zabezpieczenia w postaci paska (4 uszka)

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza worek stomijny otwarty, bez pierścienia zatraskowego, kolor przezroczysty, worek zamykany na rzep, rozmiar 50mm, 60mm oraz 70mm, możliwość stosowania dodatkowego zabezpieczenia w postaci paska (4 uszka)

Pytanie 6

Czy Zamawiający w zadaniu 11 dopuszcza:

Poz. 3

Płytki stomijne z uszkami do paska, wykonana z hydrokoloidu, rozmiar do docięcia 50/10-45mm, 60/10-55mm, 70/10-65mm

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 7

Czy Zamawiający w zadaniu 11 dopuszcza:

Poz. 4

pasta stomijna nie zawierająca alkoholu o pojemności 60g, w skład pasty wchodzi mieszanina węglowodorów alifatycznych, mieszanina węglowodanów, żelatyna, dwutlenek tytanu, dwutlenek krzemu.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 8

Czy Zamawiający w zadaniu 11 dopuszcza:

Poz. 6

worek stomijny otwarty z okienkiem, neutralny szary, posiada delikatną wypukłość 6mm, kształt dopasowujący się do nierównych obszarów wokół stomii. Dla nowo wyłonionych stomii z luźniejszą lub płynną treścią jelitową lub moczem, dla stomii wymagających dodatkowego zabezpieczenia, rozmiar 10-50mm

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 9

Dotyczy zadania 11

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (worki stomijne pakowane po 30 sztuk w opakowaniu handlowym, płytki stomijne pakowane po 5 sztuk w opakowaniu handlowym, płytka ochronna 10x10 pakowana pojedynczo, łącznie 10 sztuk w opakowaniu zbiorczym, płytka ochronna 15x15 pakowana pojedynczo, łącznie 5 sztuk w opakowaniu zbiorczym, pierścień uszczelniający pakowany pojedynczo łącznie 30 sztuk w opakowaniu zbiorczym, zmywacz w postaci chusteczek pakowane pojedynczo, łącznie 30 sztuk w opakowaniu zbiorczym, worki pooperacyjne sterylne pakowane pojedynczo, łącznie pakowane po 5 sztuk w opakowaniu zbiorczym, worki pooperacyjne niesterylne pakowane pojedynczo łącznie 6 sztuk w opakowaniu zbiorczym)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 10

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Węgrzech natomiast faktury z biura z Warszawy co uniemożliwia wysyłania towar i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin (list polecony priorytetowy). Istnieje możliwość przesyłania skanu faktury na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego (zamiast faktury przesyłanej drogą pocztową, wybór opcji należy do Zamawiającego) Czy Zamawiający dopuszcza, którąś z możliwości?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza przesyłanie skanu faktury w formacie PDF na adres mailowy **magazynu IHiT: magazyn@ihit.waw.pl**, a oryginału faktury w ciągu 5 dni roboczych listem poleconym.

Pytanie 11

Dotyczy zadania 17

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic zewnętrznie lateksowych wewnętrznie polimerowych bez taśmy adhezyjnej z mankietem rolowanym, o długości min 280 mm, grubości na palcu min 0,16 mm, dłoni min. 0,13 mm mankiecie 0,10 mm, poziomie protein poniżej 50µg/g.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 12

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odpuszczenie od wymagań dotyczących przebadania rękawicy na co najmniej 8 substancji

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 13

Dotyczy zadania 11

Sprzęt do stomii – pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 55 w miejsce rozmiaru 57?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 14

Dotyczy zadania 11

Sprzęt do stomii – pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 55 w miejsce rozmiaru 57?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 15

Dotyczy zadania 11

Sprzęt do stomii – pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 55 w miejsce rozmiaru 57?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 16

Dotyczy zadania 11

Sprzęt do stomii – pozycja 1 oraz 2 tj. worki w systemie dwuczęściowym, oraz pozycja 3 – płytki do worków w systemie jednoczęściowym: Czy Zamawiający dopuści aby uszka do mocowania paska stomijnego znajdowały się nie na pierścieniu worka stomijnego, a dwa, na płytce stomijnej? Takie rozwiązanie zapewnia jeszcze pewniejsze mocowanie sprzętu stomijnego za pomocą paska stomijnego.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 17

Dotyczy zadania 11

Sprzęt do stomii – pozycja 4: czy Zamawiający dopuści zaoferowanie odpowiedniej ilości produktu w opakowaniach jednostkowych o pojemności 100 g (18 opakowania po 100 g = 1.800 g)?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 18

Dotyczy zadania 11

Sprzęt do stomii – pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści produkt w rozmiarze 19-70mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 19

Dotyczy zadania 11

Sprzęt do stomii – pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści produkt w rozmiarze 13-60mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 20

Dotyczy zadania 11

Sprzęt do stomii – pozycja 6: Czy Zamawiający dopuści produkt w rozmiarze 13-43mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 21

Dotyczy zadania 11

Sprzęt do stomii – pozycja 8: czy Zamawiający dopuści zaoferowanie odpowiedniej ilości produktu w opakowaniach jednostkowych o pojemności 100 g (3 opakowania po 100 g = 300 g)?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 22

Dotyczy zadania 11

Sprzęt do stomii – pozycja 9: Czy Zamawiający dopuści ochronny pierścień do stosowania na podrażnioną skórę, z materiału hydrokoloidowego zawierającego aż 4 hydrokoloidy, o wyjątkowych właściwościach gojących, przyjaznych dla skóry - okrągły, o średnicy 10cm, z otworem ułatwiającym dopasowanie do odpowiedniego rozmiaru stomii?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 23

Dotyczy zadania 11

Sprzęt do stomii – pozycja 10: Czy Zamawiający dopuści ochronny pierścień do stosowania na podrażnioną skórę, z materiału hydrokoloidowego zawierającego aż 4 hydrokoloidy, o wyjątkowych właściwościach gojących, przyjaznych dla skóry - okrągły, o średnicy 10cm, z otworem ułatwiającym dopasowanie do odpowiedniego rozmiaru stomii?

Odpowiedź


Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 24

Dotyczy zadania 11

Sprzęt do stomii – pozycja 14: Czy zamawiający dopuści zaoferowanie pooperacyjnego worka niesterylnego z okienkiem, przylepiec nie w formie spirali, do docięcia do 90mm - opis i zdjęcie proponowanego worka zamieszczamy poniżej:

Niesterylny pooperacyjny worek stomijny, przezroczysty, jednoczęściowy, otwór do docięcia do 90 mm, z możliwością zamknięcia. Worek posiada podwójny sposób odpuszczania treści z worka w zależności od konsystencji odpuszczanej treści: jeśli treść jelitowa jest rzadka odpuszczanie poprzez wygodny miękki silikonowy zaworek, jeśli treść jest bardziej gęsta kranik można łatwo odciąć prostymi nożyczkami i znacząco zwiększyć wylot worka uzyskując worek z tzw. zintegrowanym zapięciem na rzep oraz unikatowym uchwytem do otwierania i opróżniania worka. Przyjazny dla skóry przylepiec z materiału hydrokoloidowego Hyperflex. Worek posiada otwierane / zamykane okienko w systemie pierścienia zatraskowego, o średnicy wewnętrznej 70 mm – umożliwiające łatwy dostęp do stomii, bez konieczności odklejania worka od skóry.

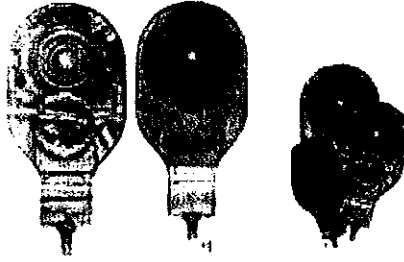

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 25

Dotyczy zadania 11

Sprzęt do stomii – pozycja 15: Czy zamawiający dopuści zaoferowanie niesterylnego worka pooperacyjnego, z okienkiem, przylepiec nie w formie spirali, do docięcia do 90mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 26

Dotyczy zadania 11

Sprzęt do stomii – pozycja 16: Czy zamawiający dopuści zaoferowanie worka pooperacyjnego z przylepcem nie w formie spirali, do docięcia do 90mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 27

Dotyczy zadania nr 3 – Rękawy – poz.1 do 12

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe, spełniające wymagania SIWZ, o wartości przenikalności powietrza $11,4 \mu\text{Pa}\cdot\text{s}$, która spełnia wymagania normatywne (PN EN 868-3 pkt. 4.4.10) i nieznacznie odbiega od wartości wymaganej?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 28

Dotyczy zadania nr 3 – Rękawy – poz.1 do 12

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe, spełniające wymagania SIWZ, o wytrzymałości na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż $7,2 \text{ kN/m}$ zamiast $7,3 \text{ kN/m}$ oraz w kierunku poprzecznym nie mniej niż $3,8 \text{ kN/m}$ zamiast 4 kN/m ? Proponowane wartości nieznacznie odbiegają od wymagań Zamawiającego oraz spełniają wymagania normy PN EN 868-3 pkt. 4.4.15.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 29

Dotyczy zadania nr 3 – Rękawy – poz.1 do 12

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe, spełniające wymagania SIWZ, o temperaturze zgrzewania 180°C – 220°C?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 30

Dotyczy poz. 9

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z zakładką o wymiarze 100mmx40mmx100m w miejsce rękawa o wymiarze 100mmx50mmx100m ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 31

Dotyczy poz. 11

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z zakładką o wymiarze 250mmx60mmx100m w miejsce rękawa o wymiarze 250mmx65mmx100m ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 32

Dotyczy zadania nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści włókninę o rozmiarze 1370x180mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 33

Dotyczy zadania nr 2 poz. 1,3,4

Czy Zamawiający dopuści włókninę niebieską - celuloza wiązana powierzchniowo, wzmocniona włóknem syntetycznym i mikrokrepowana - włókno wzmocnione włóknem syntetycznym o następującej charakterystyce wytrzymałościowej: zawartość chlorków nie więcej niż 0,03%, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,12 %, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania 2,3 kN/m; w kierunku poprzecznym 1,0 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania 2,0 kN/m; w kierunku poprzecznym 0,8 kN/m, wytrzymałość na przepuklenie 320 kPa na sucho i 200 kPa na mokro, gramatura nominalna 60 g/m² ± 5% (PN EN 868-2): wytrzymałość na rozdarcie 1150 mN w kierunku walcowania oraz 1700 mN w kierunku poprzecznym, wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta (a nie dystrybutora) w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 34

Dotyczy zadania nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści włókninę- celuloza wiązana powierzchniowo, wzmocniona włóknem syntetycznym i mikrokrepowana- włókno celulozy wzmocnione włóknem syntetycznym o następującej

charakterystyce wytrzymałościowej: zawartość chlorków 0,03%, zawartość siarczanów 0,12 %, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania 2,10 kN/m; w kierunku poprzecznym 0,9 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania 1,7 kN/m; w kierunku poprzecznym 0,9 kN/m, wytrzymałość na przepuklenie 210 kPa na sucho i 180 kPa na mokro, gramatura nominalna 57 g/m² ± 5% (PN EN 868-2): wytrzymałość na rozdarcie 1050 mN w kierunku walcowania oraz 1550 mN w kierunku poprzecznym, wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta (a nie dystrybutora) w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2 ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 35

Dotyczy zadania nr 17

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki chirurgiczne z lateksu, bezpydrowe o zawartości protein ≤50 µg/g w rozmiarach od 6,0 do 9,0?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 36

Pytanie dot. projektu umowy:

Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych rozumiane jako *dni od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych*. Poprawiony projekt umowy został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 37

Pytanie dot. projektu umowy:

Czy zamawiający zgadza się na zamianę słowa „opóźnienia” na słowo „zwłoki”?

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy w projekcie umowy bez zmian.

Pytanie 38

Pytanie dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy w projekcie umowy bez zmian.

Pytanie 39

Pytanie dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy w projekcie umowy bez zmian.

Pytanie 40

Dotyczy zadania nr 7 poz. 1-4

Prosimy Zamawiającego o możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym sztuk na opakowania po 100 szt.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 41

Dotyczy zadania 7 pozycje 1-2

Czy Zamawiający dopuści możliwość wyceny igieł za opakowanie a'100 szt. z przeliczeniem ilości lub podania ceny za 1 szt. z dokładnością do 4 miejsc po przecinku, gdyż cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej igły) ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 42

Dotyczy zadania nr 7, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści igły do nakłucia lędźwiowego o długości 3,5'' (90mm), spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza igły do nakłucia o długości 90 mm.

Pytanie 43

Dotyczy zadania nr 17 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne występujące w rozmiarach 6,0-9,0; polimerowane oraz lekko chlorowane od zewnętrznej jak i wewnętrznej strony rękawicy; z rolowanym mankietem; o długości 280-300 mm w zależności od rozmiaru, o grubości na palcu 0,23mm, na dłoni 0,20mm na mankiecie 0,18mm; spełniające pozostałe parametry siwz?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 44

Dotyczy zadania nr 17 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o poziomie protein poniżej 50 µg/g?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 45

Dotyczy zadania nr 17 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice przebadane na min. 8 cytostatyków zgodnie z normą EN 374 w tym, carmustyna gdzie przenikanie pojawia się w 45 minucie?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 46

Dotyczy Zadania nr 1, pozycja nr 1, 2 i 6

Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu przedstawienia przez Wykonawcę potwierdzenia zgodności z normą lub potwierdzenia klasy przez niezależną organizację notyfikowaną z uwagi na to, iż;

- stawianie przez Zamawiającego takiego wymogu narusza przepis art. 30. ust. 1. i 4., ustawy Prawo Zamówień Publicznych, które w swej części między innymi zobowiązuje Zamawiającego do opisywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem Polskich Norm, co w tym przypadku Zamawiający obowiązany jest formułować swe wymogi w zgodzie z normą ISO 11140, która w całej swej treści nie przewiduje w żadnym przypadku wymogu certyfikowania wyrobów niemedyceńskich przez niezależne jednostki notyfikowane,

- takie postępowanie Zamawiającego uniemożliwia potencjalnym Wykonawcom złożenia ofert cenowo niższych nawet do kilkudziesięciu procent, co skutkuje zawyżoną wartością zadania.

Czy, Zamawiający miast wymaganego potwierdzenia zgodności z normą lub potwierdzenia klasy przez niezależną organizację notyfikowaną dopuści złożenie dokumentów o których mowa w § 6. ust.3., Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r., w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 47

Dotyczy zadania nr 1, pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści taśmę o szerokości 25mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 48

Dotyczy zadania nr 1, pozycja nr 4, 5

Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie testów biologicznych o terminie ważności nie krótszym niż 12msc? Testy biologiczne ze względu na obecność w składzie żywych mikroorganizmów cechują się krótszym terminem przydatności.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 49

Dotyczy zadania nr 1, pozycja nr 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu równoważnego w postaci paska bibuły nasączonego sporami w bardziej profesjonalnym opakowaniu z papieru pergaminowego zabezpieczającego przed kontaminacją?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 50

Dotyczy zadania nr 1, pozycja nr 8

Czy Zamawiający dopuści taśmę o szerokości 19mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 51

Dotyczy zadania nr 1, pozycja nr 10-11, 13-14

Uprzejmie prosimy o włączenie wskazanych pozycji do oddzielnego pakietu. Asortyment stanowią produkty stosowane w procesie mycia i dezynfekcji. Podział pakietu pozwoli na złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź

Zamawiający wyłączy w/w pozycje do oddzielnego zadania. Nowo brzmiący załącznik został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 52

Dotyczy zadania nr 1, pozycja nr 11

Czy Zamawiający dopuści testy mycia umieszczone na specjalistycznym, plastikowym podłożu zawierające mieszaninę odpowiednio dobranych komponentów, posiadające substancję wskaźnikową, umieszczoną w jednym miejscu na teście oraz badające proces mycia w jednej płaszczyźnie, które pozwalają na sprawdzenie wszystkich czynników mających wpływ na skuteczność procesu mycia.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 53

Dotyczy Zadania nr 4, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści przezroczyste osłonki przeznaczone dla narzędzi o maksymalnej szerokości 25mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 54

Dotyczy Zadania nr 3, pozycja 1- 12

Czy Zamawiający dopuści rękawy o przepuszczalności powietrza 10,29 $\mu\text{m}/\text{Pa.s}$?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 55

Dotyczy Zadania nr 3, pozycja 1-12

Czy Zamawiający dopuści rękawy o wytrzymałości na przepuklenia 359Kpa?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 56

Dotyczy Zadania nr 3, pozycja 1-12

Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 57

Dotyczy Zadania nr 3, pozycja 1- 12

Czy w celu wykluczenia wielokrotnego użycia opakowań Zamawiający wymaga, aby na rękawach umieszczony był piktogram przekreślonej liczby 2, który informuje o tym, iż zaofertowane opakowanie jest jednorazowego użytku?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 58

Dotyczy Zadania nr 3, pozycja 1- 12

Czy Zamawiający wymaga rękawów papierowo-foliowych, na których znajduje się oznaczenie obowiązujących norm, tj. ISO 11607-1 oraz EN 868 cz. 2-5, co jest wymagane przez obowiązujące normy?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 59

Dotyczy Zadanie 7 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły iniekcyjnej w rozmiarze 0,5 standard zamiast cienkościennej, reszta parametrów i rozmiarów zgodna z SIWZ

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 60

Dotyczy Zadania nr 7 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do nakłucia o długości 90 mm, spełniających pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza igły do nakłucia o długości 90 mm.

Pytanie 61

Dotyczy Zadania nr 7, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje aby oferowane igły tępe do bezpiecznego pobierania leków z fiolek z nasadką w kolorze czerwonym umożliwiły w zakresie rozmiaru 18G dobór długości igły (40 mm i 25 mm) w zależności od potrzeb użytkownika? Igła o długości 25 mm pozwala zmniejszyć straty pobieranych leków, gdyż umożliwia pobór większej ilości leku z fiolek bez konieczności wycofywania igły, który to grozi wyciekami roztworu i skażeniem zarówno leku, jak i osoby pobierającej.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty na igły aspiracyjne z filtrem do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków zgodnie z opisem zawartym w SIWZ, tj. w rozm. 1,2x40 mm.

Pytanie 62

Dotyczy Zadania nr 17, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o odpuszczenie rękawic chirurgicznych, lateksowe bezpydrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu 0,27 mm, AQL = 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, średni poziom protein < 10 ug/g rękawicy (badania niezależne, nie starsze niż 2012 r.) mankiet rolowany,

opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe, długość 270-285 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (dokument z wynikami badań dla min. 7 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jednostkę notyfikowaną), badania na przenikalność cytostatyków min. 9 czas przenikania >240 min (raporty z wynikami badań). Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

Z-ca D Y R E K T O R A
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
d/s techniczno-administracyjnych
mgr Witold Kmiotek